



Application du critère 8k V2010





Maintenance

8k

- C'est quoi le problème?**
Définir la criticité des DM dans tous les services et être en conformité du critère 8k
- Qui est concerné par le problème?**
Les patients, Service bio, et les service de soins
- Comment résoudre ces problèmes?**
En définissant les DM critiques
- Pourquoi faut-il résoudre ce problème?**
Pour la prévention de risques liés aux DM critiques
- Protéger la santé des patients contre les risques liés aux DM critiques
- Etablir les priorités de la maintenance MP, MC, CQ des DM les plus critiques
- S'assurer que les services disposent de DM critiques fiables et conformes à la réglementation
- S'inscrire dans une démarche qualité

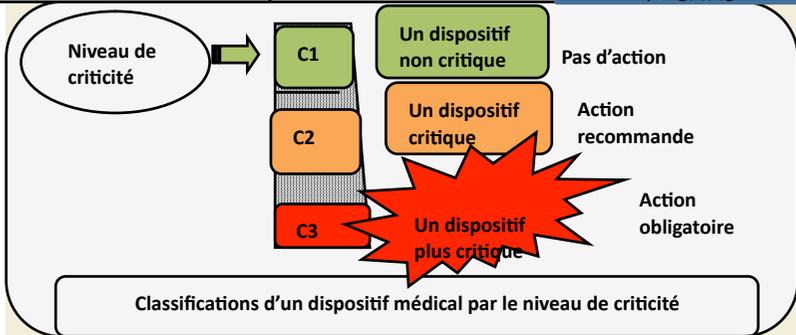

SERVICES : PHARMACIE										Date						
RESPONSABLE										22/06/2011						
NOM:										PRENOM:						
SERVICES BIOMEDICAL																
NOM:										PRENOM:						
										NIVEAU DE GRAVITE				CRITICITE		
Code	Désignations des DM	Prix	Marque/ model	Mise en service	Santé du patient	Qualité des soins	Santé du personnel	Biens matériels	Risque juridique	l'image de l'établissement	Total gravite	Age	Coef Age	frequence Maint Curative	Total Criticité	
027650	AUTOCLAVE A VAPEUR	44322	KH 66/101	01/06/1997	Grave	Grave	significatif	Sérieux	significatif	Significatif	4	14	3	1	16	
027651	SOUDEUSE SACHETS INSTRUMENTS	4068,1	A1000	01/06/1991	Grave	Grave	significatif	Sérieux	significatif	significatif	4	20	18	0	72	
030068	MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS	21114	G7826	10/09/2003	Mineur	Sérieux	significatif	Sérieux	Mineur	Mineur	3	8	2	1	9	
030094	OSMOSEUR	5405	RIOS 8	01/09/2003	Mineur	Mineur	Mineur	Sérieux	Mineur	Mineur	3	8	2	0	6	
030114	BALANCE DE PRECISION	1218	EG22006-2N	25/01/2005	Sérieux	Sérieux	Mineur	Sérieux	Mineur	Mineur	3	6	2	0	6	
030328	ISOLATEUR	40000	NOMINAT 5	22/09/2005	Grave	Grave	significatif	Sérieux	significatif	significatif	4	6	2	0	8	
0102101	MACHINE A NETTOYER A ULTRASONS	1952,5	S90H	25/05/2010	Mineur	Sérieux	Significatif	Sérieux	Mineur	Mineur	3	1	1	0	3	

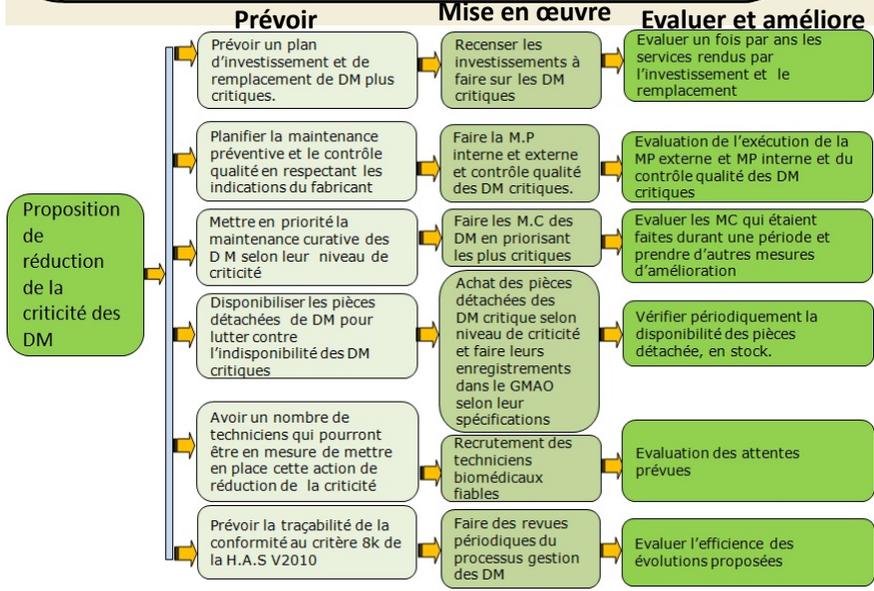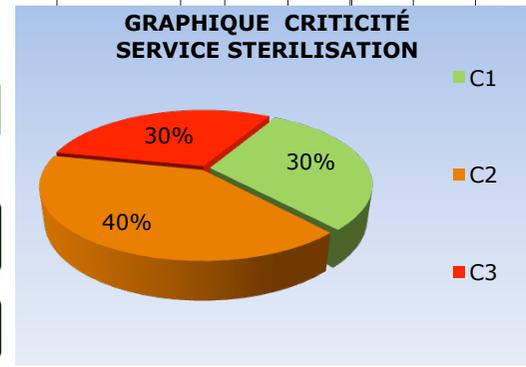

conclusion

La criticité des dispositifs médicaux qui est le centre du présent rapport est un élément capital qui devrait susciter une attention particulière notamment dans l'exploitation des dispositifs médicaux.

BIBLIOGRAPHIE

[3] http://www.infirmiers.com/pdf/maintenance_DM.pdf

[5] <http://www.utc.fr/tsibh/public/spibh/03->
<http://www.utc.fr/tsibh/public/abih/11/stage/BUGINGO/index.html>