



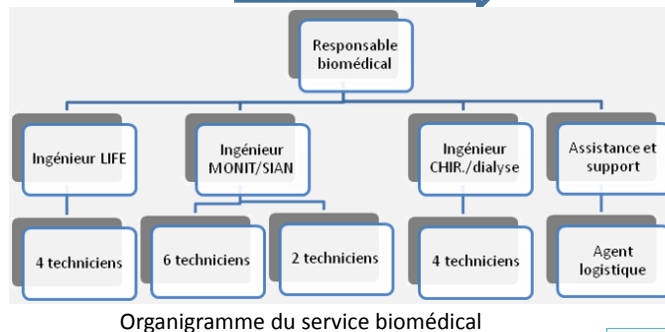

Historique

étape par étape Contrôles qualité internes externes

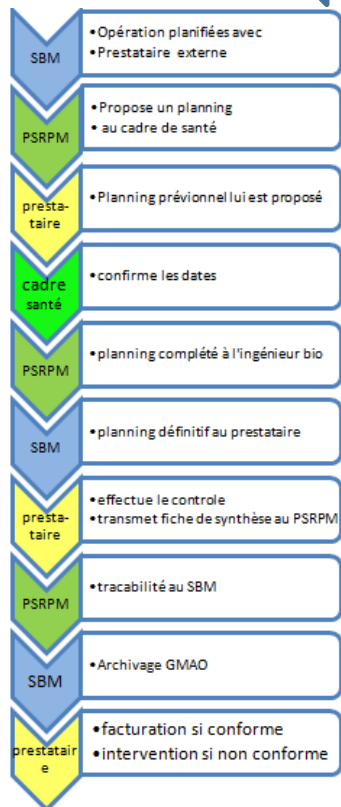

Organigramme du service biomédical

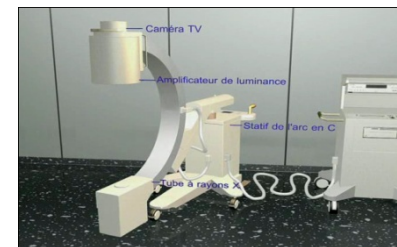


Image d'un ampli de brillance

Maintenance préventive	Contrôle qualité interne	Contrôle qualité externe	Contrôle externe radioprotection	Total contrôles à effectués
80	50	50	50	230

Estimation du nombre de contrôles annuels

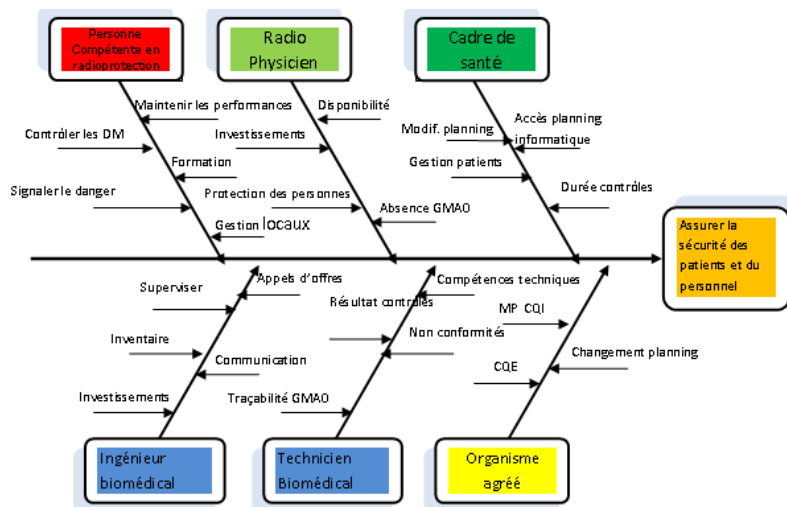
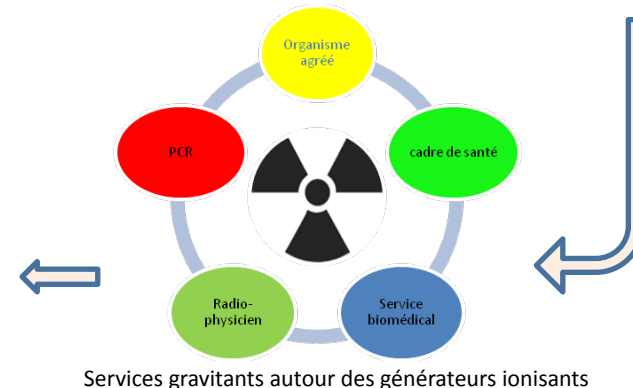


Diagramme ISHIKAWA: Rôle des différents services

Secteur	Description des matériels	INVENTAIRE	SALLE	N°SYSTEME	Janv.	Fevr.	Mars
RADIO Clém	MOBILE DE RADIOGRAPHE	9405528	Dermato	75392			
BLOC URG	MOBILE DE RADIOSCOPE	200705370	Bloc Urg	30234431			
NEURO RAD	STATIF ARCEAU PLAFONNIER	200405174					
NEURO RAD	TABLE PLATEAU HV	200405175					
NEURO RAD	GENERATEUR DE RADIOLOGIE	200405183	Allura	92249			
NEURO RAD	STATION DE GRAVAGE	200405191					
NEURO RAD	TUBE RX	200405184					

Inventaire et Planning

Contrôles des Mobiles de Radiographie





Figure 31 : % Travaux effectués

Travaux effectués

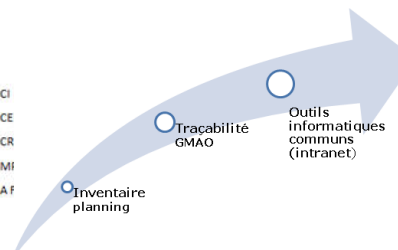

Amélioration de la communication