


Réalisation du planning de maintenance préventive au centre hospitalier d'Orsay




Situation

Centre Hospitalier d'Orsay :

de suivi de la Maintenance Préventive (MP)
un technicien biomédical interne au parc
ente installation de la GMAO (gestion
maintenance assisté par ordinateur
entaire de 1363 DM

Contexte réglementaire [1]

DE 93/42 CEE

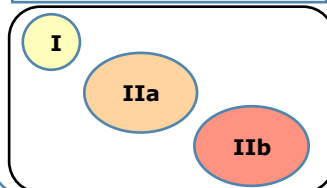

Arrêté du 03/03/03

- Liste Des Dispositifs Médicaux Soumis À L'obligation De Maintenance
- Liste Des Dispositifs Médicaux Soumis Au Contrôle De Qualité Externe
- Liste Des Dispositifs Médicaux Soumis Au Contrôle De Qualité Interne


NF S 99170:2013 Exploitant

Système de management de la qualité pour la maintenance et la gestion des risques

- Plan de gestion des risques
- Plan de gestion des DM

Analyse des modes de défaillance et des risques des DM [2]

des D.M soumis à obligation de maintenance préventive



Une analyse des modes de défaillance permettra de savoir le taux de criticité de ces DM.

CRITICITE:
C =
P * I * E * U

Rapport entre la criticité et la tolérance de réalisation

criticité	Tolérance (jours)	Nombre s DM
>10	30 jours	233
<10	15 jours	370
0	0 jours	130

Incrémentation [3]

Logiciel de GMAO "ASSET PLUS"



Amélioration continue

re à jour l'inventaire des DM
re à jour les opérations de maintenance des DM
sibiliser les exploitants aux risques liés à la gestion des DM
seigner les causes et les coûts des pannes à la GMAO

- Baisse des maintenances préventives en retards
- Baisse des temps de non fonctionnement
- Meilleure gestion des coûts de maintenance
- Augmentation de la sécurité des personnes

Planning de maintenance préventif

PHASE DU PROJET	DÉBUT	FIN
MP BISTOURIE	08/01/2015	27/01/2015
MP VENTILATEUR DE REA	05/02/2015	16/02/2015
MP VENTILATEUR D'ANESTHESIE	17/02/2015	28/02/2015
MP DEFIBRILLATEUR	12/03/2015	30/03/2015
MP CAMERA	01/04/2015	21/04/2015
MP CENTRIFUGEUSE	07/07/2015	30/07/2015
MP INCUBATEUR DE SOINS INTENSIF	07/06/2015	20/06/2015
MP MODULE	29/07/2015	11/08/2015
MP MONITEUR	12/08/2015	31/08/2015
MP POUSSE SERINGUE	03/09/2015	14/09/2015
CQI RADIO	03/12/2015	14/12/2015
CQE RADIO	16/09/2015	06/10/2006

Bibliographie

Contexte réglementaire: consultable sur www.lne.fr, <http://www.legifrance.gouv.fr>, et <http://www.afnor.org>
Mode de criticité PIEU: consultable sur <http://www.utc.fr> en PDF rubrique management et qualité
Logiciel de GMAO : consultable sur <http://www3.gehealthcare.com>
Source d'image: <http://www.w12.fr>