


Grille d'autodiagnostic sur le critère 8k de l'H.A.S v 2010

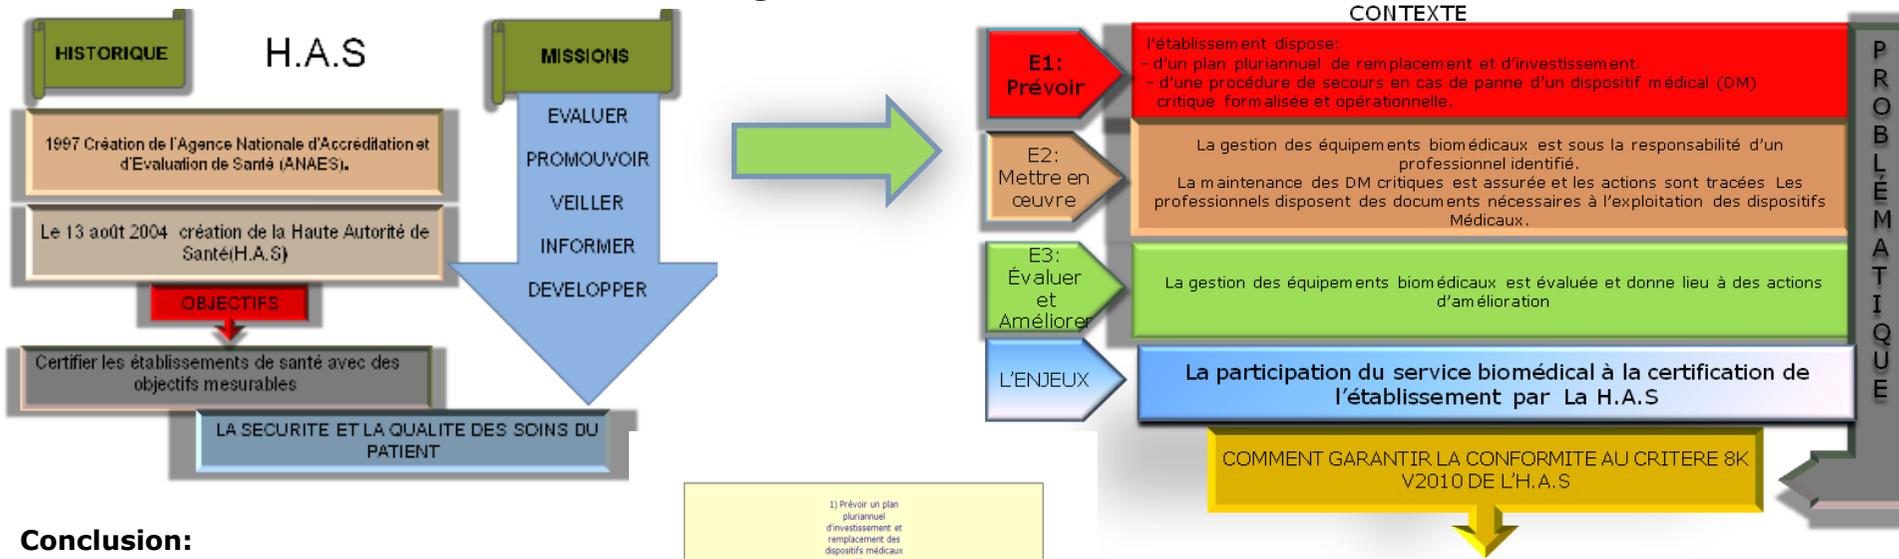


Conclusion:


Cette grille d'autodiagnostic a été élaborée dans le but d'apporter une aide aux services biomédicaux dans l'interprétation du critère 8k de la H.A.S .

Elle peut être enrichie et exploitée.

Elle devra dans tous les cas validée par la communauté biomédicale .

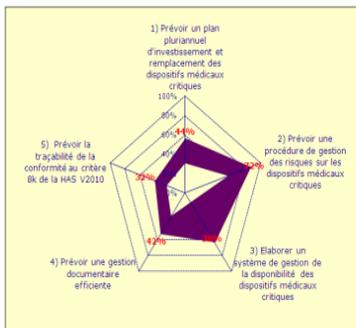

| GRILLE D'AUTODIAGNOSTIC: critère 8k « gestion des équipements biomédicaux Référentiel H.A.S – v2010 | | | |
|---|--------------|-------------|----------------|
| Etre conforme au critère 8k (selon les niveaux E1,E2 et E3) | | | |
| Processus de gestion des équipements biomédicaux selon le critère 8k | | | |
| Prévoir un plan pluriannuel d'investissement et de remplacement des DM critiques | H.A.S Niveau | Evaluations | Mode de preuve |

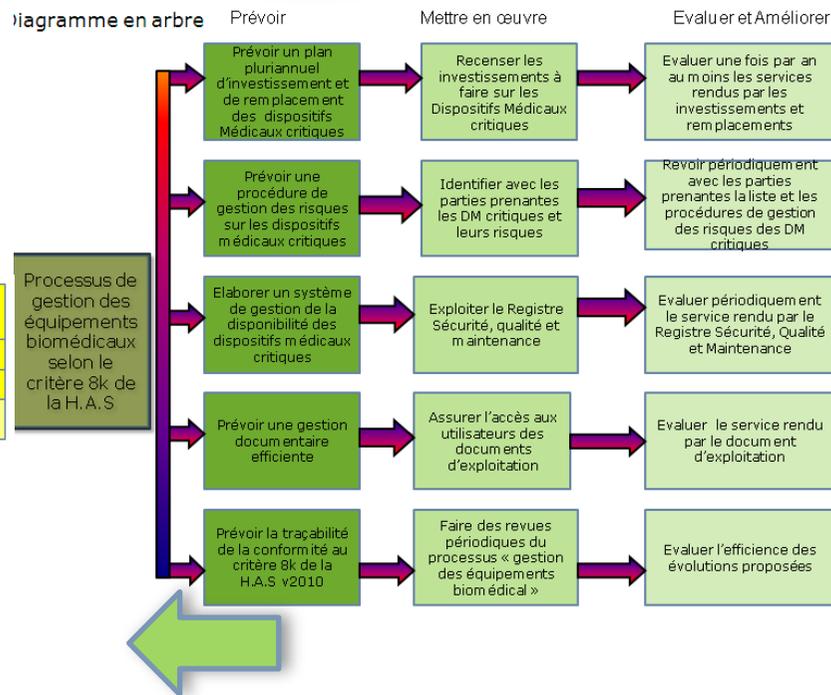

Bibliographie :

<http://www.has-sante.fr>

http://www.utc.fr/farges/bonnes_pratiques/bpb-ht

<http://www.legifrance.gouv.fr/>

décret 2001-1154 du 5 décembre 2001 définissant une obligation de maintenance organisée sur les dispositifs médicaux
 Arrêté du 3 mars 2003 fixant les listes des dispositifs médicaux soumis à l'obligation de maintenance et au contrôle de qualité mentionnés aux articles L. 5212-1 et D. 665-5-3 du code de la santé publique .

<http://sagaweb.afnor.org/>

norme NF 599-171 : maintenance des dispositifs médicaux – modèle et définition pour l'établissement et la gestion du registre sécurité , qualité et maintenance d'un dispositif médical (RSQM)

<http://midi-pyrenees.sante.gouv.fr>

